

METRAMEX, by FAICIC
VERACRUZ, MEX.

Nombre: GONZALEZ ARTEAGA ID: PICARDO
 Sexo: Masculino Edad: 39
 Factor: 100(Hispano)
 Estatura: 162cm Peso: 85kg IMC: 32.4

Transductor tipo Turbina

(*corresponde al mejor automático; ^ al mejor manual)

	FEV1	FVC	FEV1/FVC	PEF	Variac.	Advertencia	Hora:
Basal	Fecha: 01/01/00						
Basal	3.03	3.39	89.4	395	-4%	Corto soplo 00:05	
Basal	3.12	3.50	89.1	454	-1%	Corto soplo 00:06	
Basal	3.14	3.55	88.4	434	*	Corto soplo 00:07	

Variación está basada en FVC.

ATS/ERS Criterio de Calidad (Forzada):


Basal: Satisfecho (3 Corto soplo).

Mejor resultado de la espirometría:

	Basal	%Pr	Min	Pred	Max	Post	%Pr	%Chg
FEV1	3.14	101	2.47	3.12	3.77			1
FEV6	3.55							1
FVC	3.55	95	3.02	3.73	4.43			1
PEF	434	92	279	472	666			1/min
FEV1/FVC	88	107	72	83	94			%
FEF25-75	3.66	106	1.91	3.45	4.99			1/s
FET	3.0							s

Interpretación (ATS): Espirometría normal.

Lazo Volumen Flujo

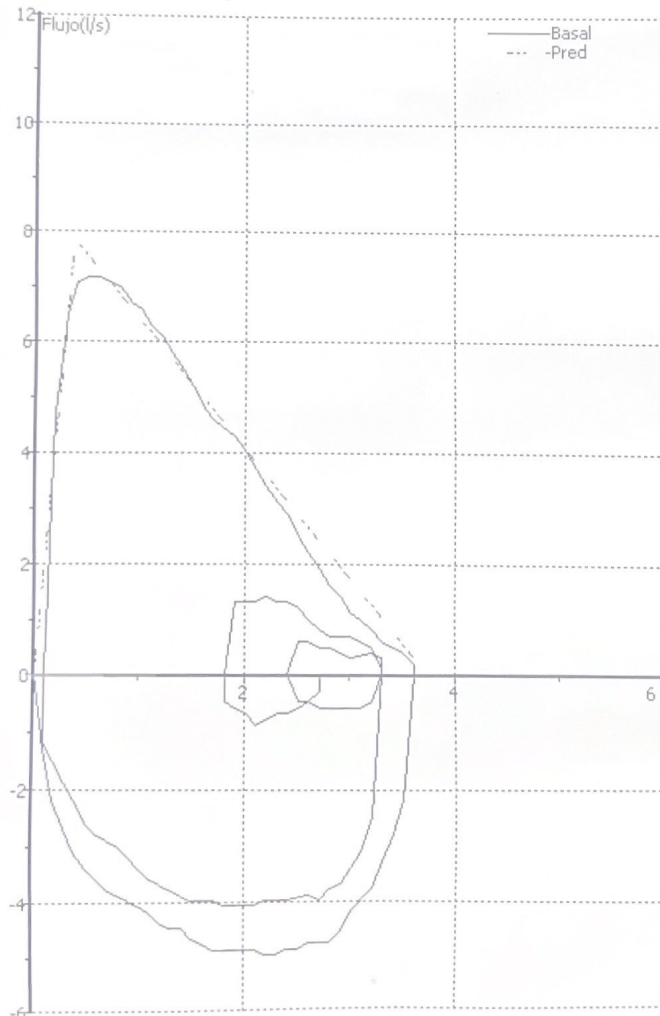

Valores Normales: Knudson (Adulto);
 Knudson (Niño)
 Resultados a BTPS