

METRAMEX, by FAICIC
VERACRUZ, MEX.

Nombre: **REY GABRIEL ANDRÉS UTZ.**
 Sexo: Masculino Edad: 26
 Factor: 100 (Hispano)
 Estatura: 169cm Peso: 64kg IMC: 22.4

Transductor tipo Turbina

(*corresponde al mejor automático; ^ al mejor manual)

FEV1 FVC FEV1/FVC PEF Variac. Advertencia Hora:

Basal Fecha: 01/01/00

Basal	3.58	3.92	91.3	680	0%	Comienzo lento	00:09
Basal	3.79	3.79	100.0	678	-3%	Final abrupto	00:11
Basal	3.95	3.96	99.7	637	0%	Final abrupto	00:12
Basal	3.93	3.93	100.0	667	*	Corto soplo	00:13

Variación está basada en FVC.

ATS/ERS Criterio de Calidad (Forzada):


Basal: No satisfecho. Se necesitan 2 soplos buenos más.

Mejor resultado de la espirometria:

	Basal	%Pr	Min	Pred	Max	Post	%Pr	%Chg	
FEV1	3.93	99	3.14	3.96	4.79				l
FEV6	3.93								l
FVC	3.93	83	3.82	4.71	5.60				l
PEF	667	124	318	539	760				l/min
FEV1/FVC	100	119	73	84	95				%
FEF25-75	6.66	154	2.39	4.32	6.26				l/s
FET	1.2								s

Interpretación (ATS): **Espirometria normal.**

Lazo Volumen Flujo

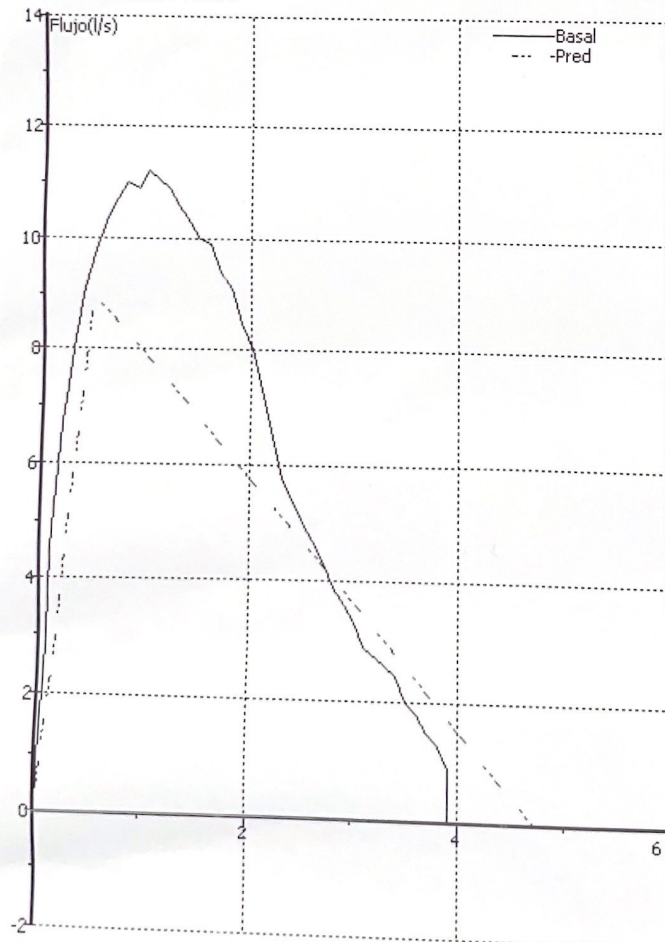

Valores Normales: Knudson (Adulto);
 Knudson (Niño)
 Resultados a BTPS